

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2026年第3期（总第993期）

物理科学与技术学院党政办公室

2026年4月24日

2026年4月学院实验室安全检查情况通报

2026年4月24日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查发现，大部分实验室物品摆放有序，化学药品按照要求存放。但部分实验室仍存在下述问题：（1）烘箱上放置可燃物；（2）易制毒药品未上锁（3），卫生环境脏乱差。

经学院实验室安全工作组商议，本次实验室检查不对实验室警告扣分。但对下列实验室提出整改提示，下个月检查中，如果未整改或继续被整改提示，将进行警告扣分处理。

格致楼 1036：机械泵漏油未清理、烘箱上面放置可燃物



格致楼 2039: 一氧化氮气体没有气瓶架




格致楼 2027: 高温炉使用记录不全



格致楼 2010: 插线板不符合新国标、实验室脏乱



格致楼 3010: 高温炉工作记录不全

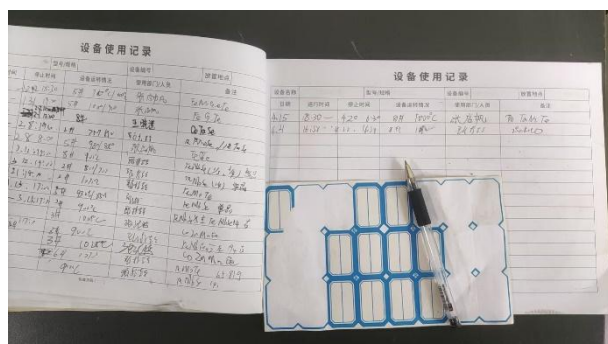


格致楼 1010: 实验室卫生差



格致楼 1012: 实验室卫生差



理工楼 111: 实验室人员无人使用的情况下, 易制毒药品丙酮未入柜上锁, 放在通风橱




理工楼 1401: 重物阻挡电源柜门



理工楼 1419: 卫生脏乱差



理工楼 1420: 实验室无人情况下, 易制毒药品柜未上锁, 易制毒丙酮放在桌面和通风橱



理工楼 1425：卫生脏乱差



理工楼 1322：插线板放在地面

